

I N S T R U C C I O N E S



VIDA  
AL  
CUBO


2 0 2 3

Los tratamientos convencionales contra diversos tipos de cáncer como son las **quimioterapia / radiación**, destruyen físicamente las células degeneradas para detener el crecimiento del tumor, pero también dañan otros tejidos y órganos adyacentes, provocando graves efectos secundarios.

El **Cargador de Mitochondrias\*** induce apoptosis ('muerte celular programada') al reactivar los motores moleculares que producen la energía que hace funcionar las células de un tejido/órgano. Esto lo hace de forma cómoda, no invasiva y sin efectos secundarios. Dependiendo del diagnóstico clínico, edad, tratamiento y síntomas del usuario potencial, el **Cargador de Mitochondrias\*** se personaliza para que pueda proporcionar **gradientes de protones**, energía segura y no invasiva enviada usando fonones (cuasipartícula no ionizante, no térmica) en los tejidos del área afectada.

Esta terapia restaura el proceso natural del cuerpo, con el que se deshace de las células inútiles, inflamadas y viejas de manera controlada

# ¿QUÉ INCLUYE?

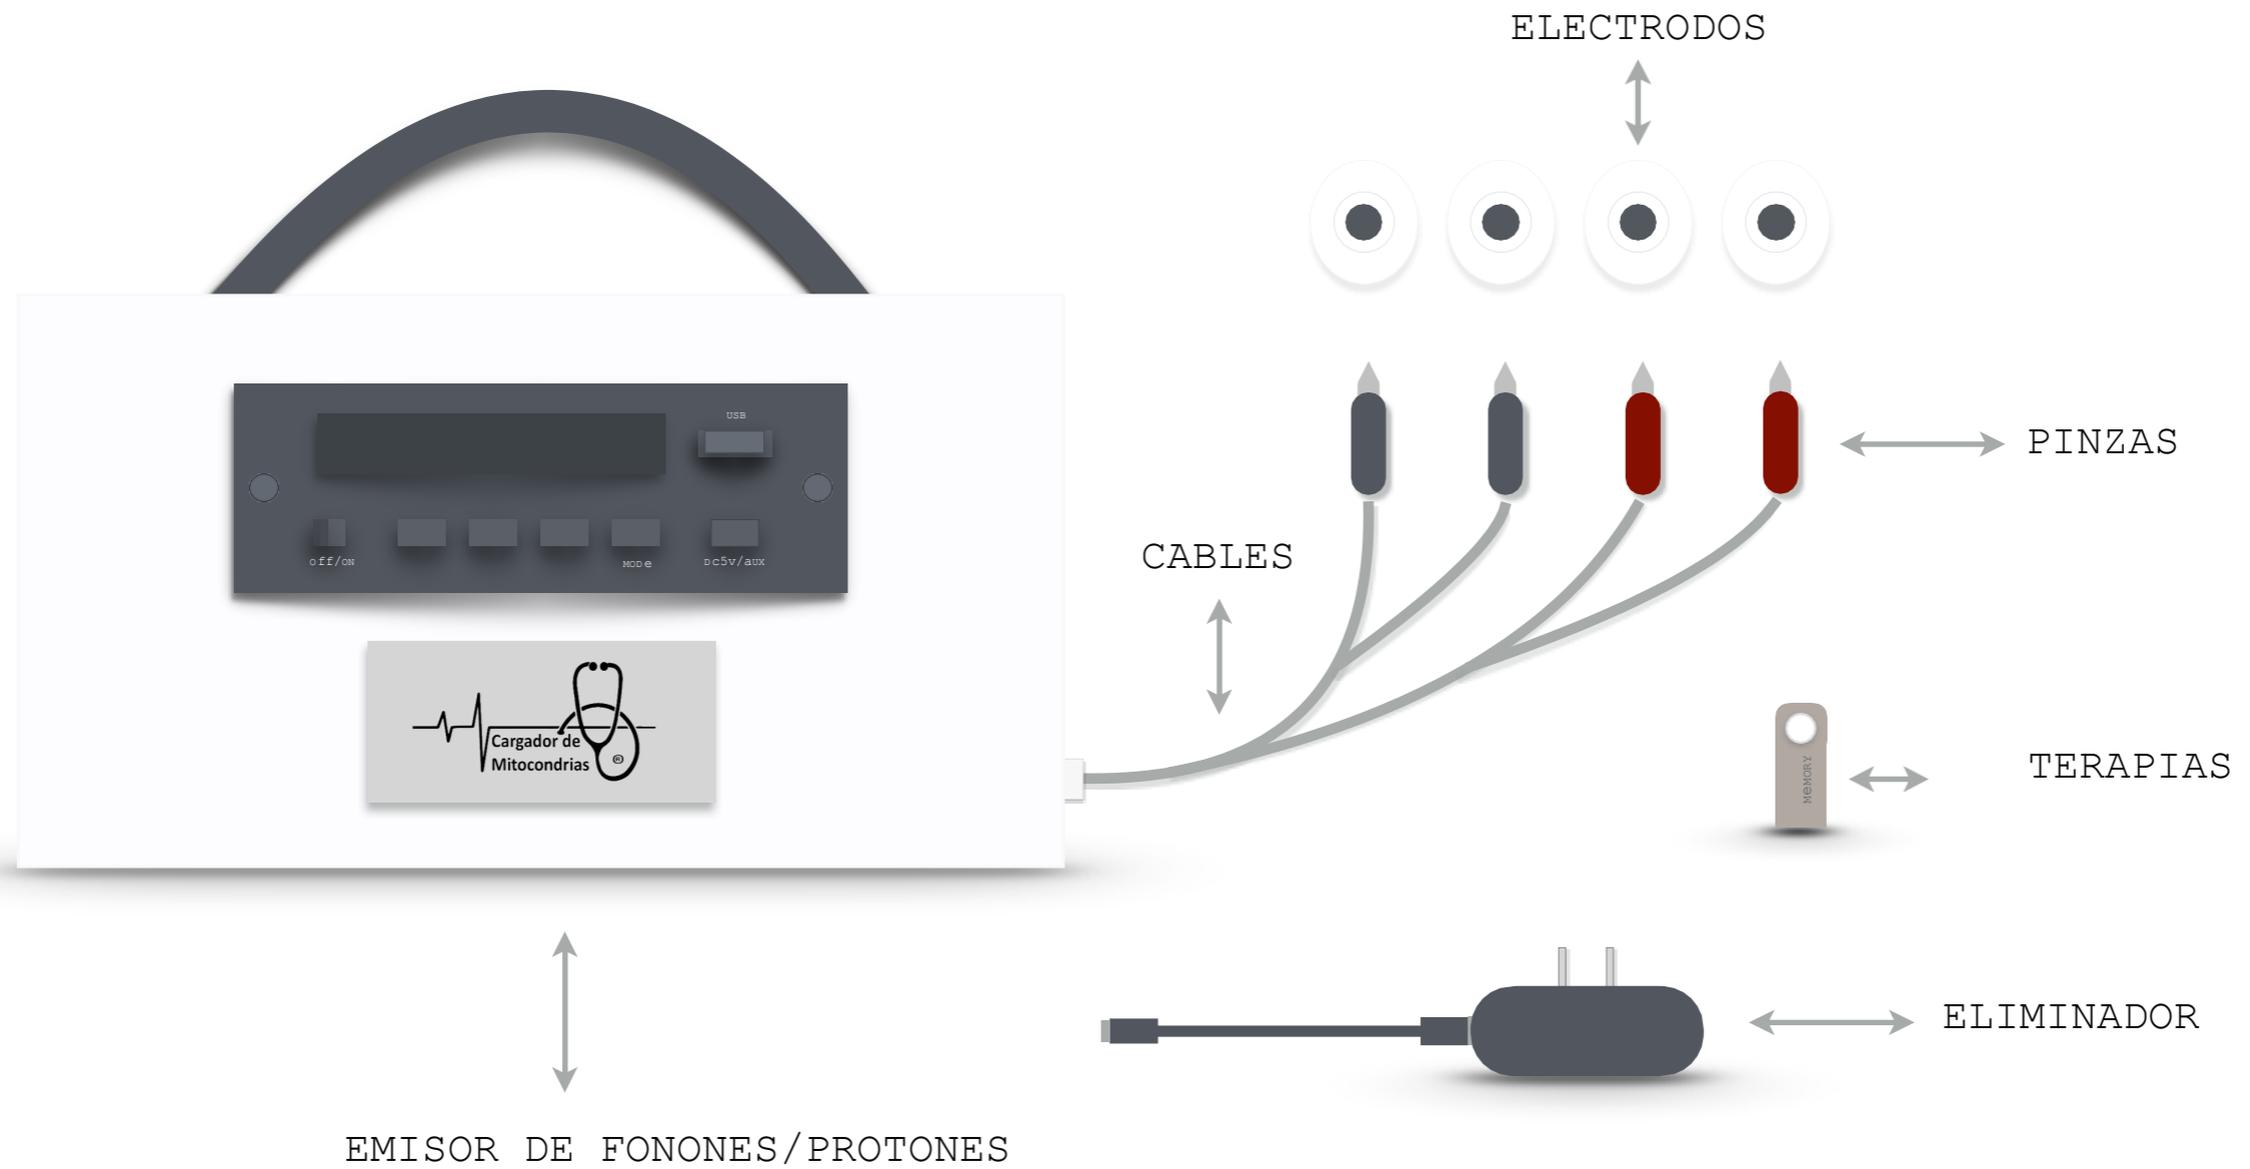


¡Gracias por adquirir el **Cargador de Mitocondrias** !

# PASOS A SEGUIR

IMPORTANTE SEGUIRLOS CORRECTAMENTE

1

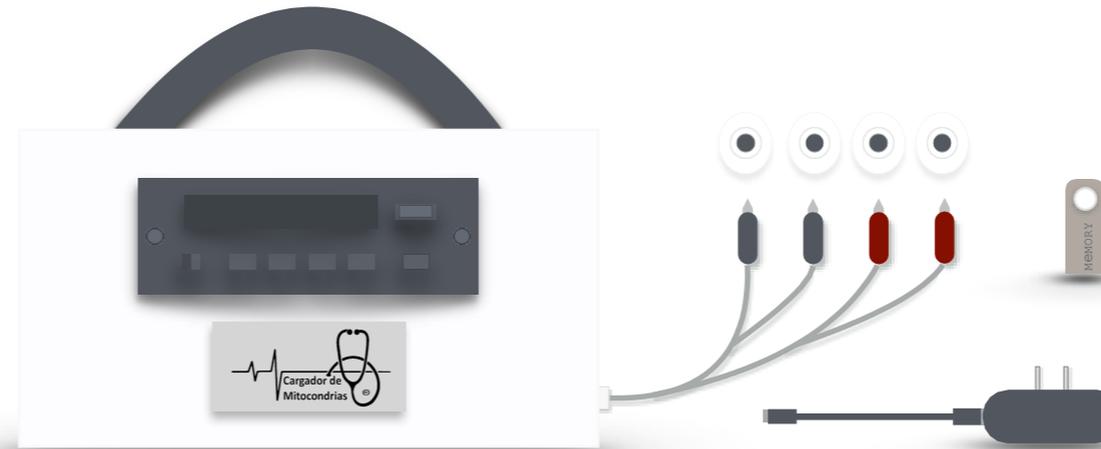

DESEMPAQUE EL CARGADOR DE MITOCONDRIAS

IMPORTANTE: NO GOLPEAR, NO TIRAR Y NO JALAR LOS COMPONENTES

2




LEA LAS INSTRUCCIONES DEBAJO DEL EMISOR

(LOS EQUIPOS NECESITAN CARGARSE DE 4 A 5 HORAS ANTES DE USARSE POR PRIMERA VEZ. SIN EMBARGO TODOS SE ENVÍAN PRE-CARGADOS PARA ACELERAR LA APLICACIÓN.

# PASOS A SEGUIR


IMPORTANTE SEGUIRLOS CORRECTAMENTE

3

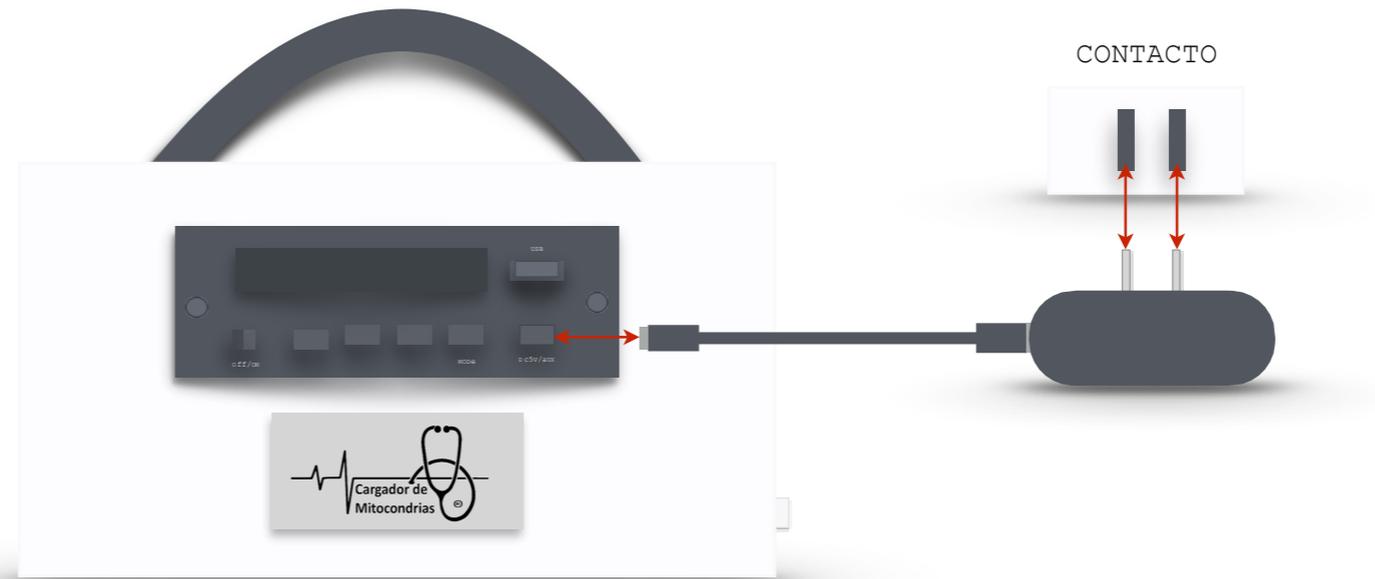

CONECTE EL ELIMINADOR


4

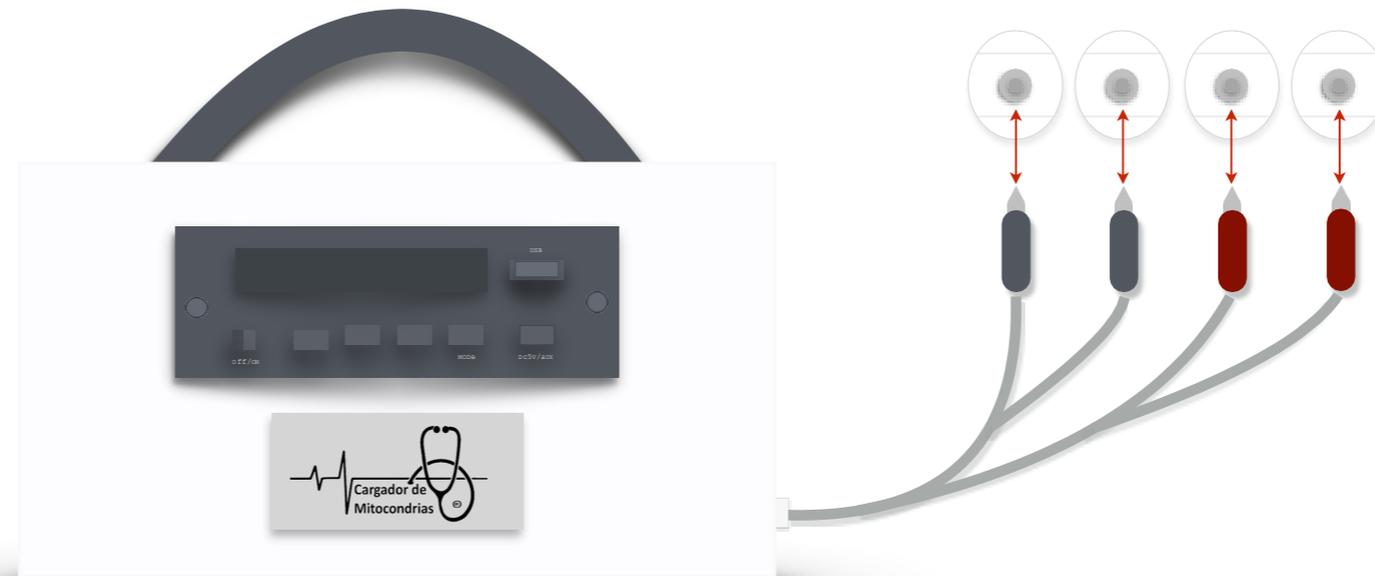

COLOQUE ELECTRODOS EN LAS 4 PINZAS


4

COLOCACIÓN SUGERIDA EN EL CUERPO

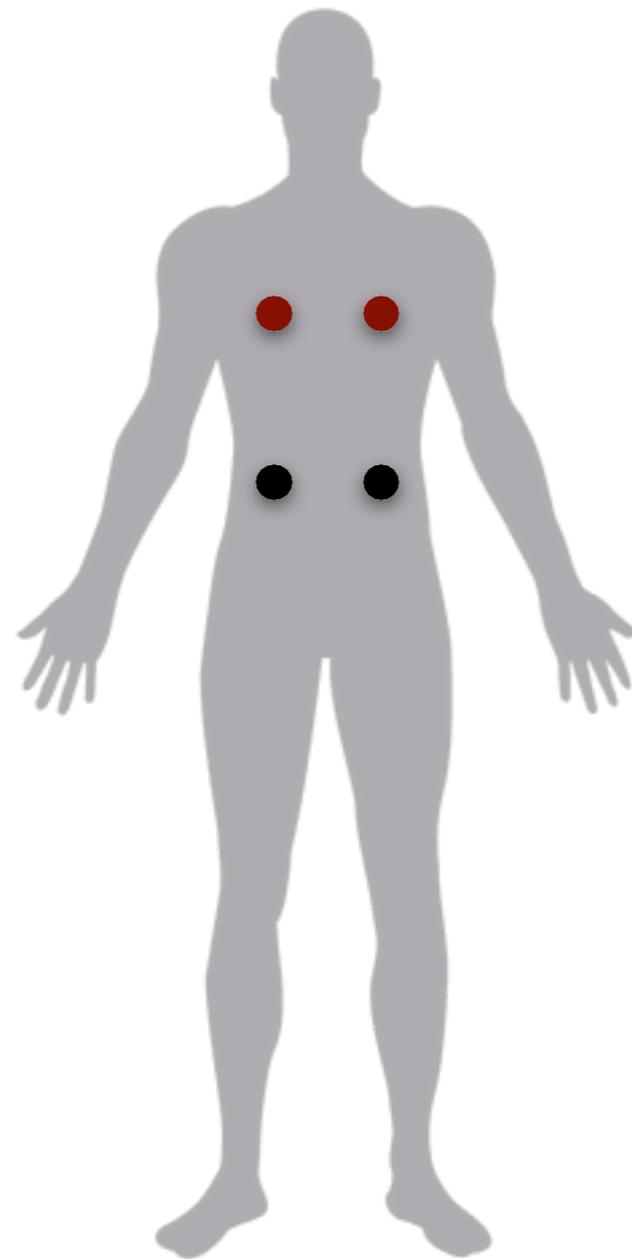

METÁSTASIS  
MANTENIMIENTO INMUNE


CASOS

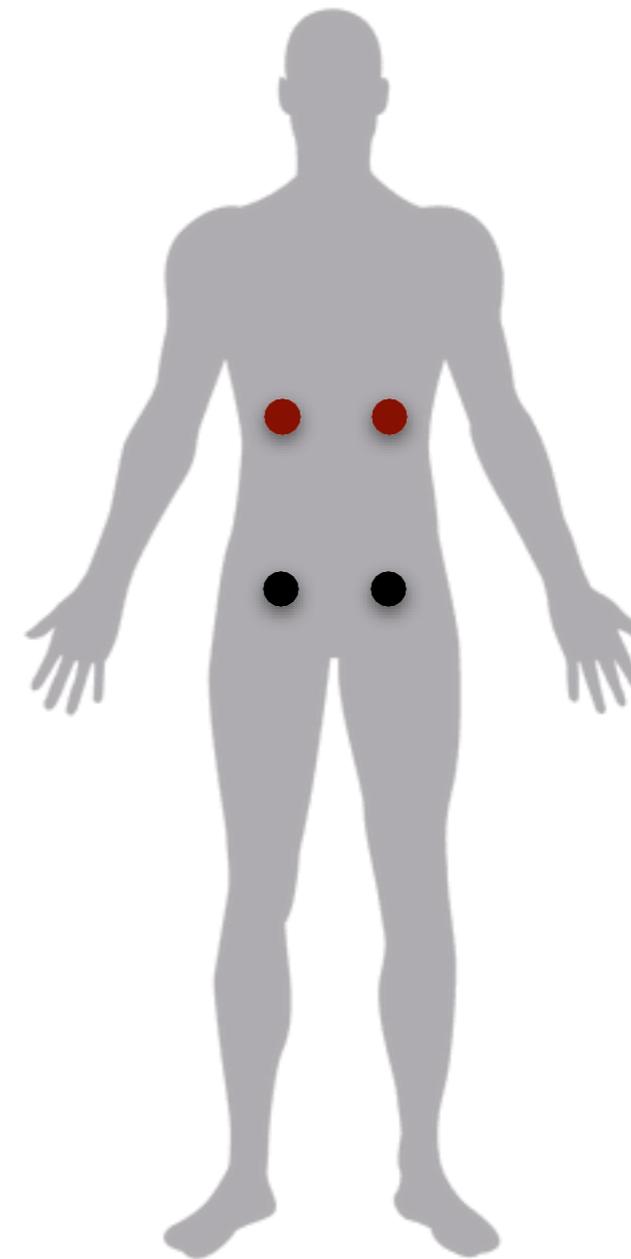

OVARIO  
PRÓSTATA  
ÓRGANOS BLANDOS


5

# COLOCACIÓN SUGERIDA EN EL CUERPO

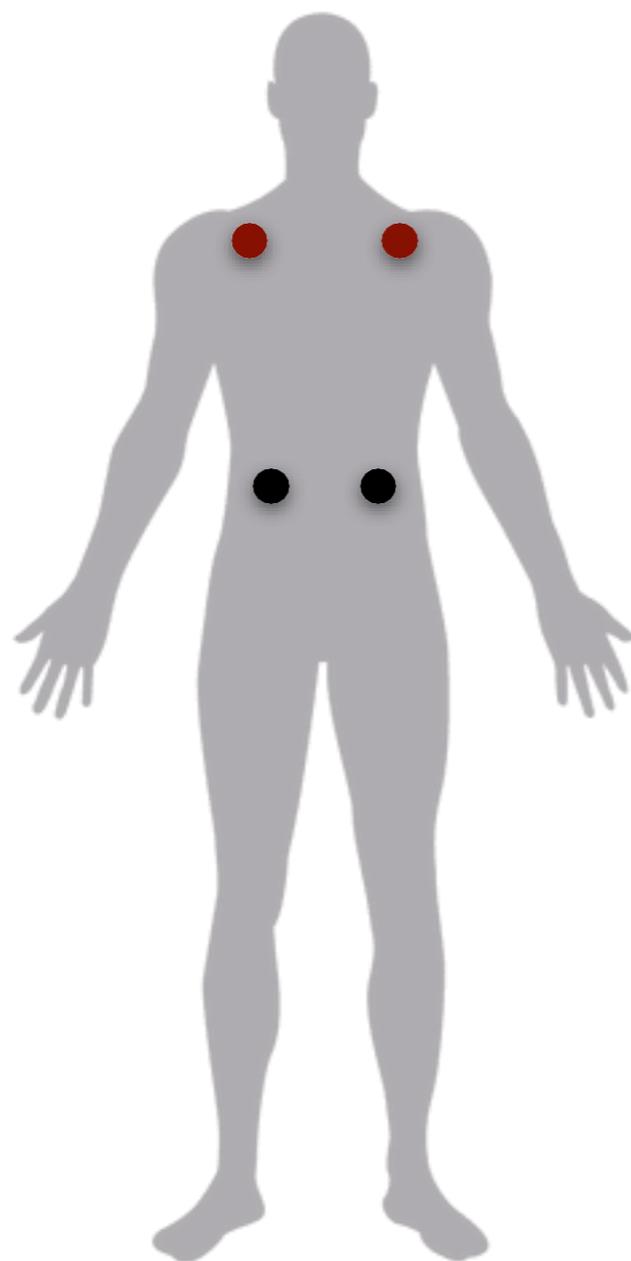


PULMONES  
PECHO  
TIROIDES

CASOS

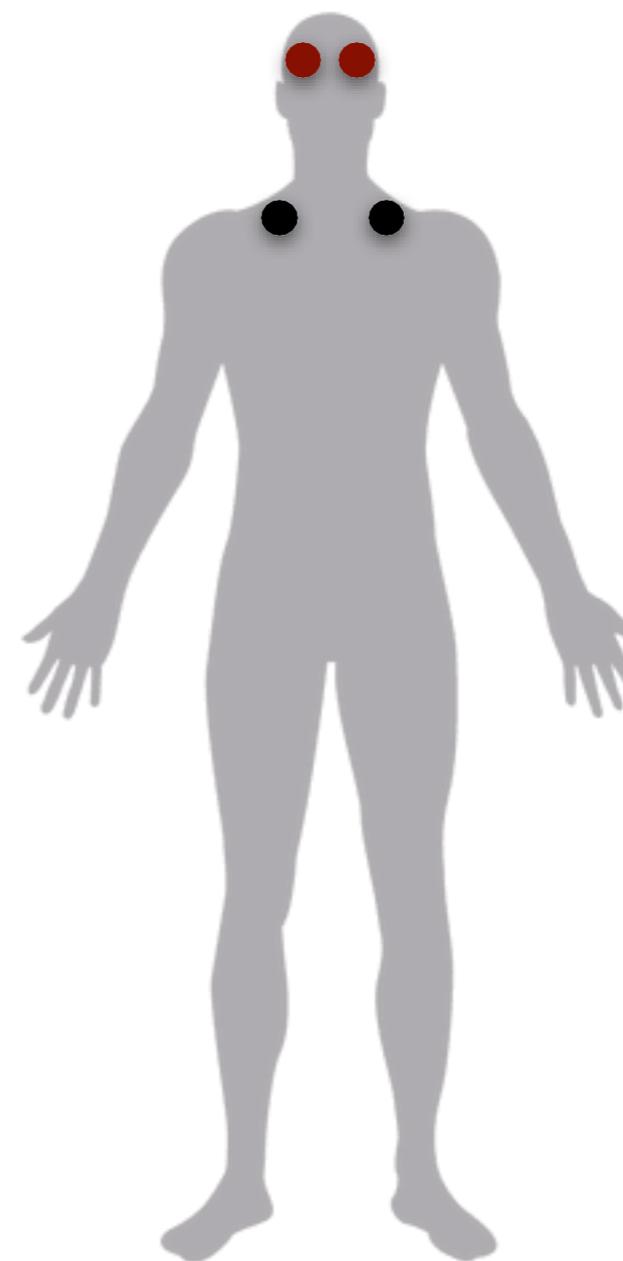


CABEZA  
CUELLO

# COLOCACIÓN SUGERIDA EN EL CUERPO

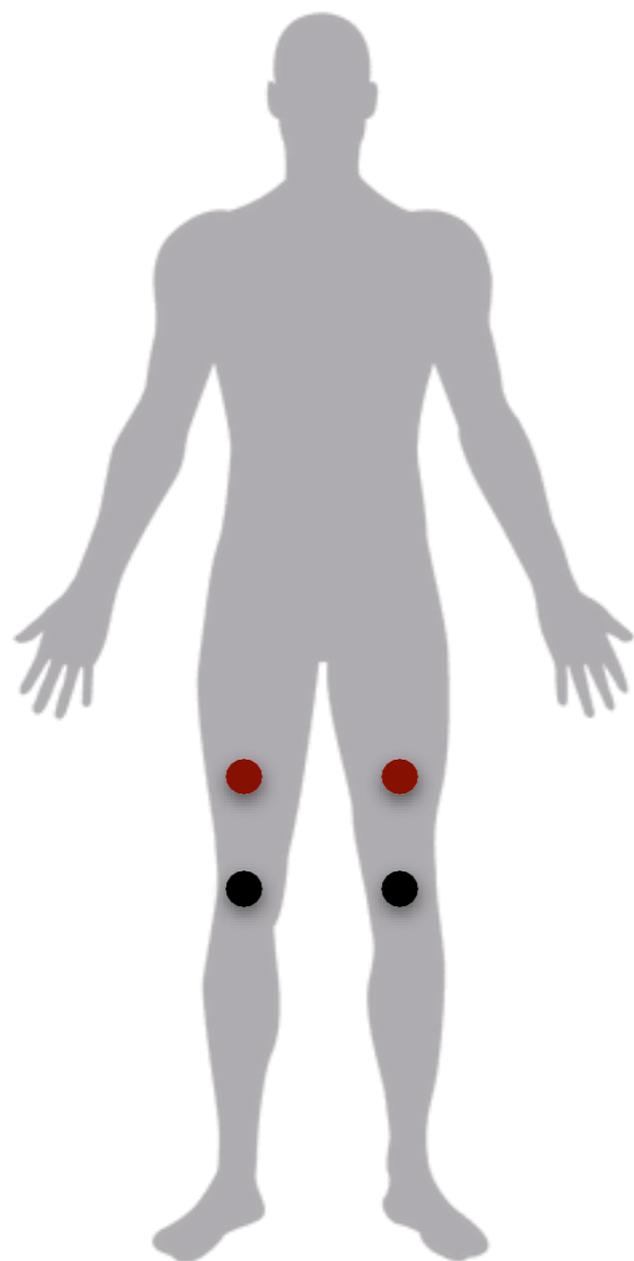

EXTREMIDADES BAJAS

CASOS

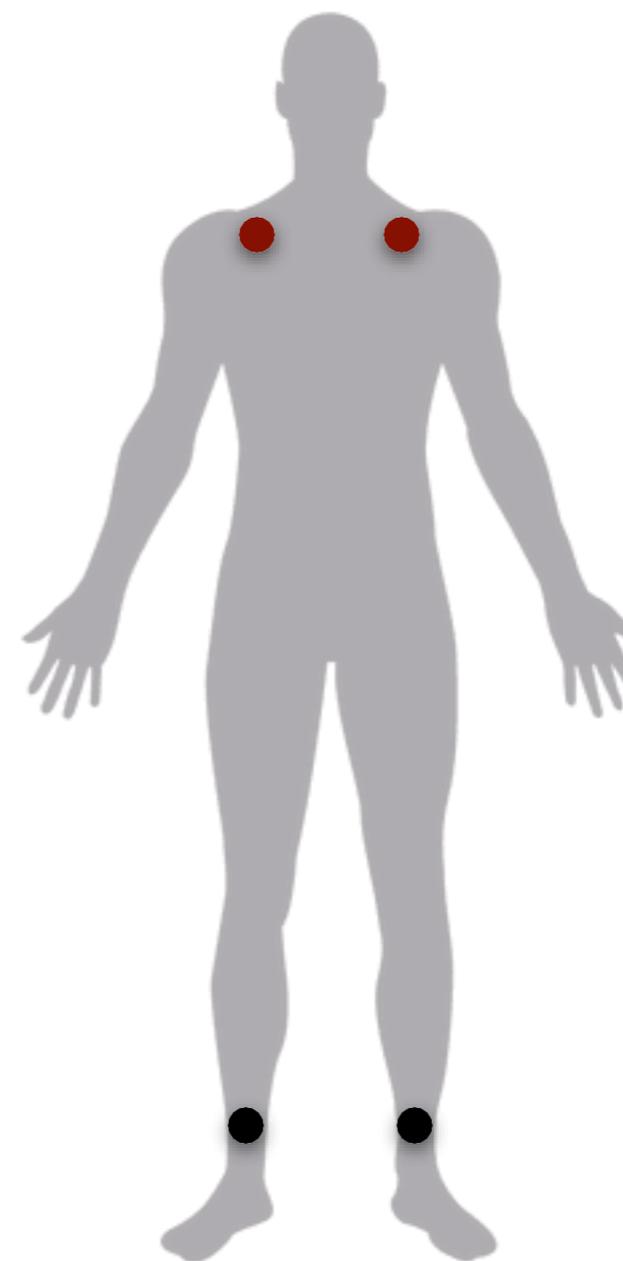

INCONSCIENCIA

7

## **Electrodos**

Los mismos electrodos pueden ser utilizados varias ocasiones. Es recomendable retirarlos del cuerpo para dar tiempo a que respire la piel del usuario.

Cuando el **Cargador de Mitocondrias\*** no esté en uso, los electrodos deberán ser cubiertos con el plástico transparente. La mala condición de los electrodos afecta la conductividad y el rendimiento de la unidad. Cuando los electrodos pierden su calidad adhesiva, es posible reactivar su adherencia mediante la aplicación de un fino chorro de agua o poniendo encima un trozo de cinta microporo.

Una vez que los electrodos han perdido su calidad adhesiva, se sugiere colocar electrodos de repuesto.


Para adquirir una bolsa con 50 electrodos de repuesto, solicitar nuevas terapias o reparar un **Cargador de Mitocondrias\*** dañado, comuníquese.

E L E C T R O D O S




9

UNA VEZ COLOCADOS LOS ELECTRODOS  
CONECTE A LA CORRIENTE Y  
ENCIENDA EL **CARGADOR**

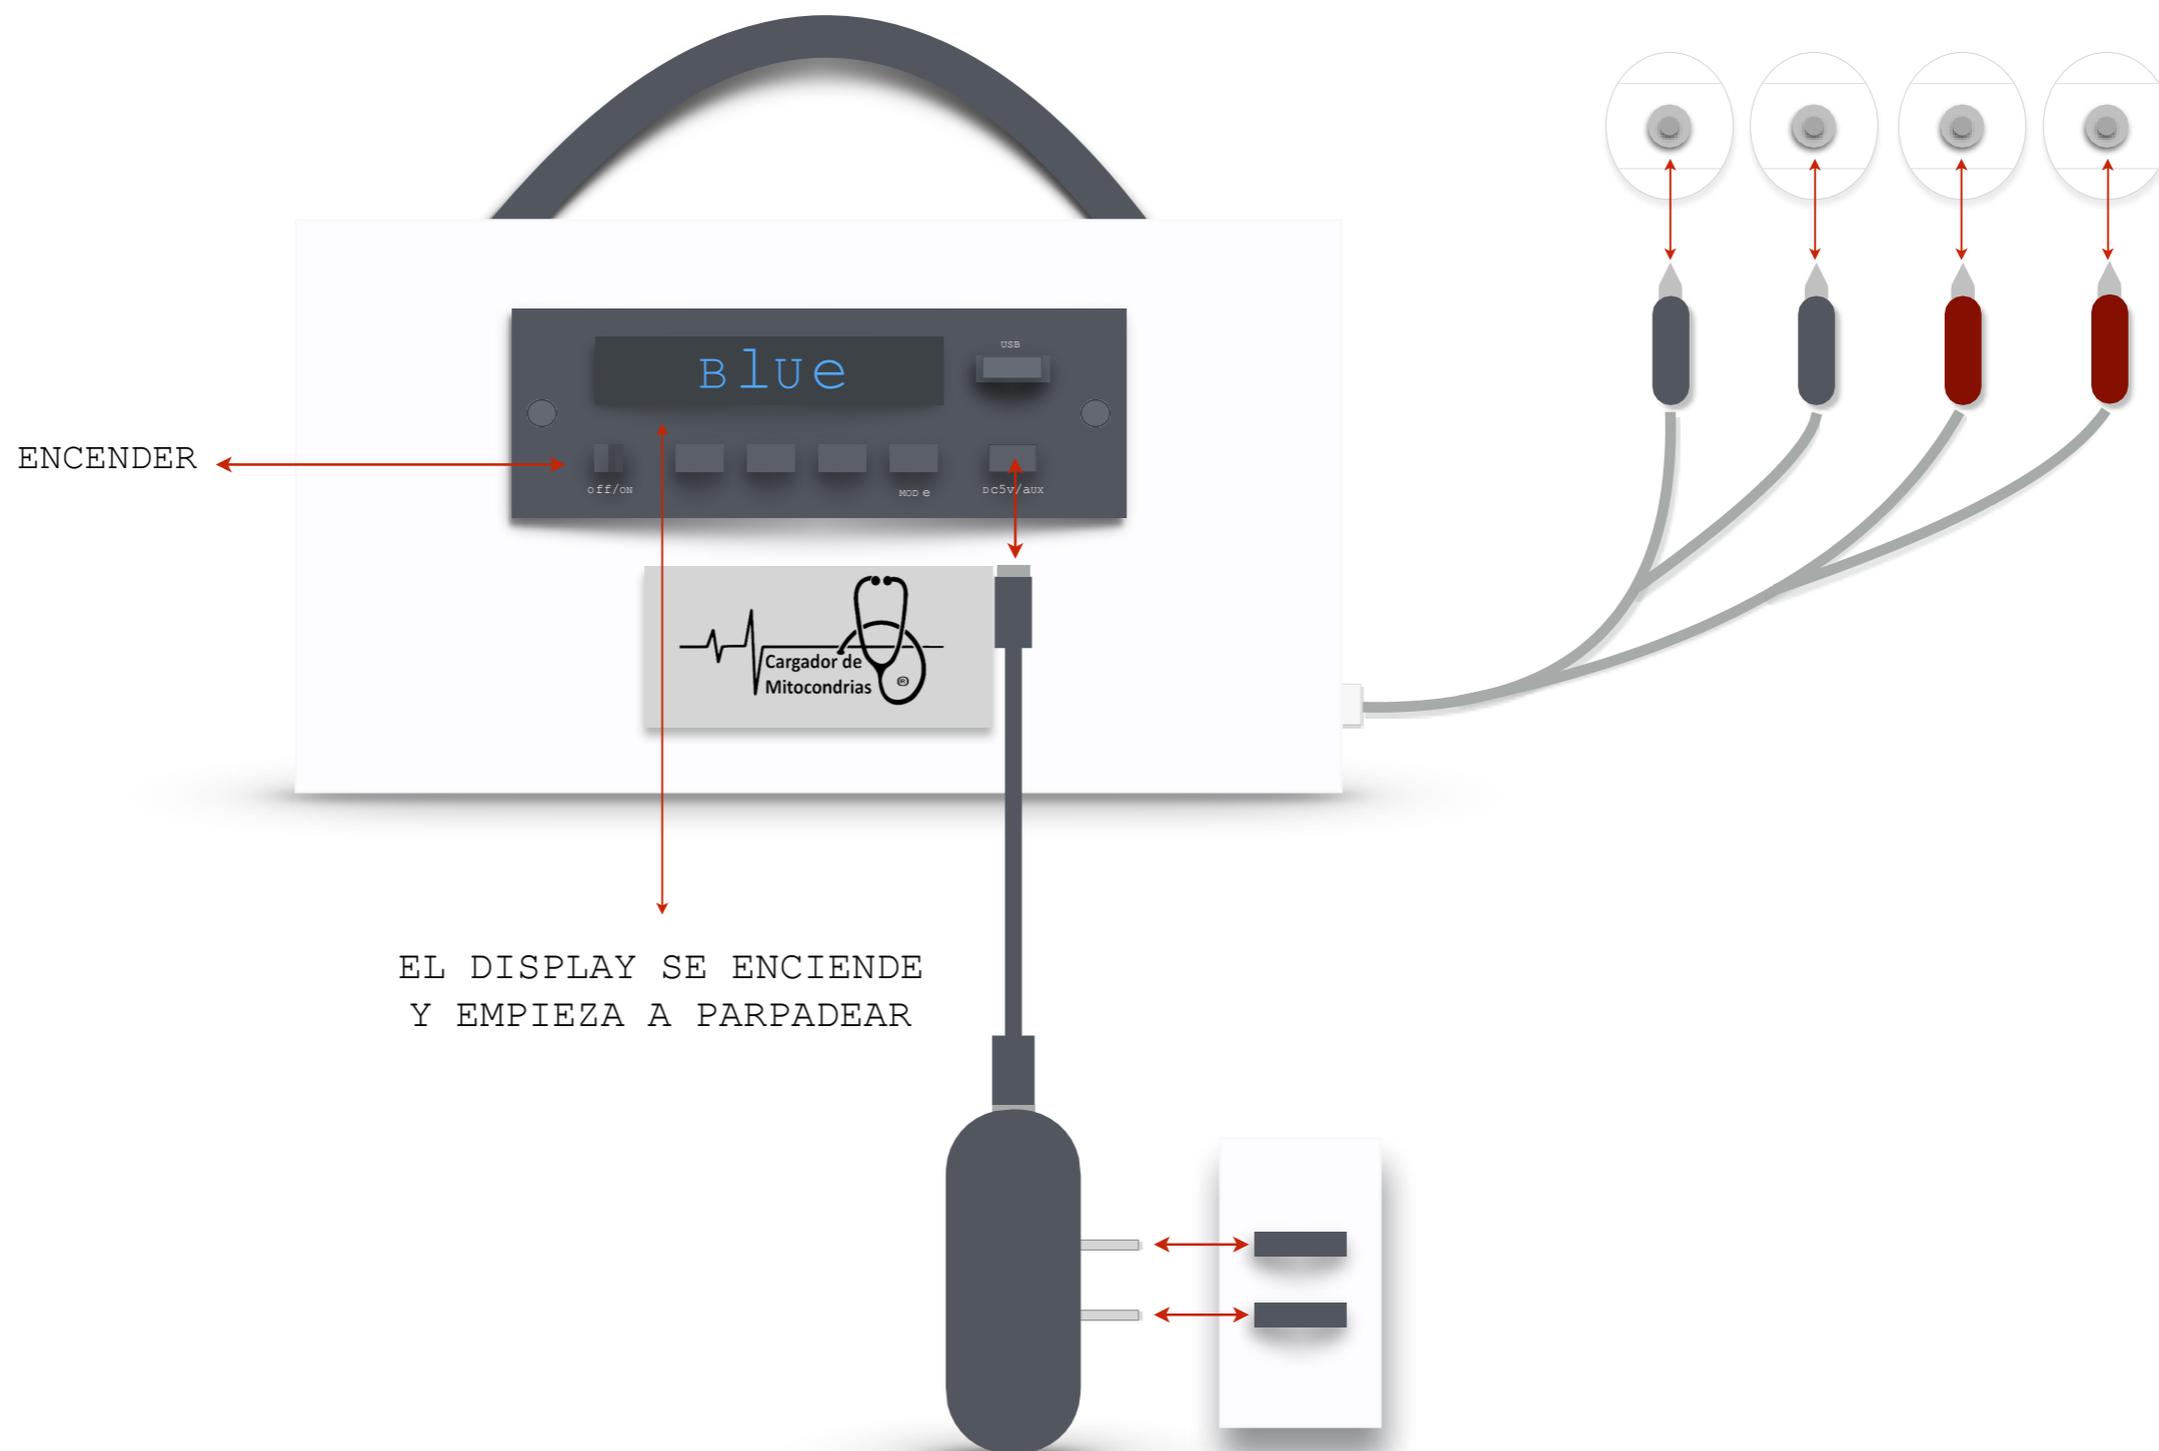


# Elija la terapia indicada


Al elegir la terapia, el display mostrará el contador de pulsos.

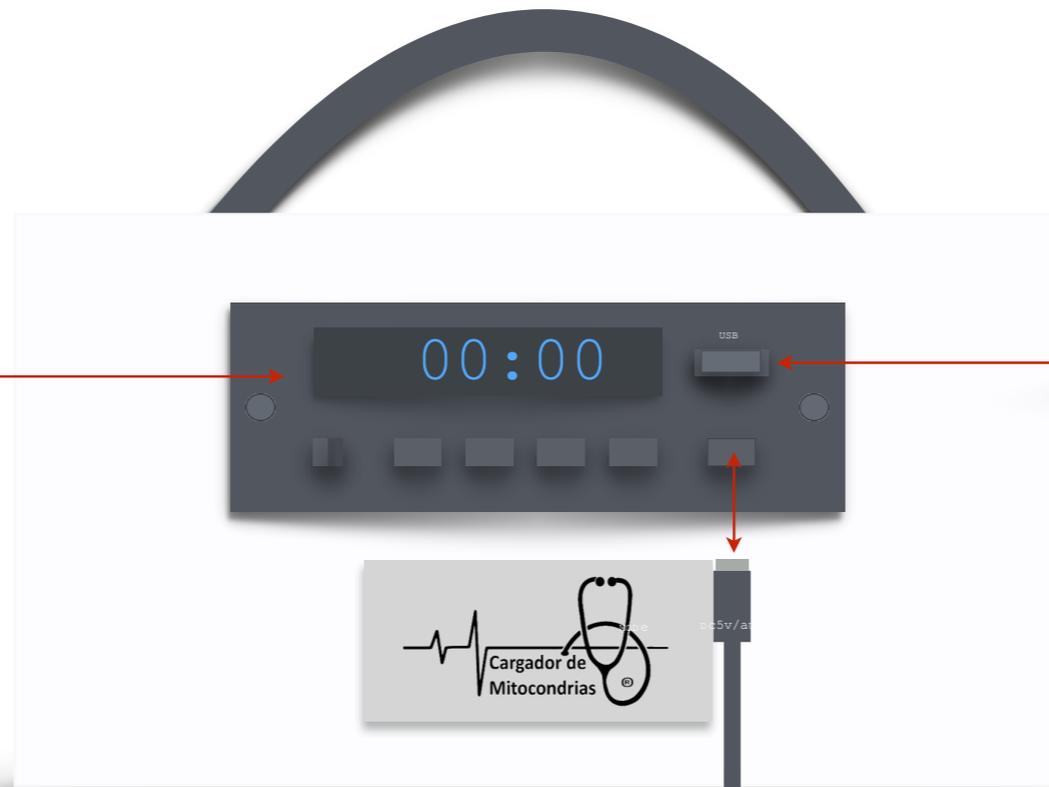


Instrucciones colocadas en la ranura (usb)

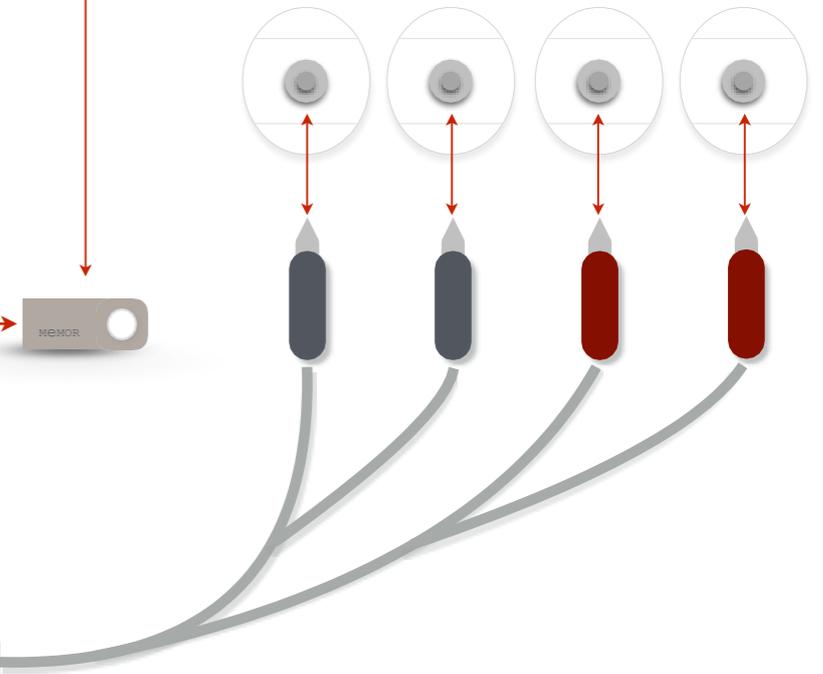

10

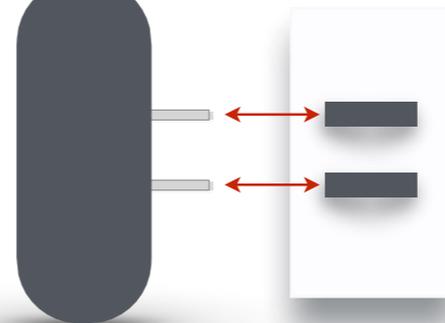

Una vez que aparezca el contador de pulsos, la terapia inicia.  
**¡Siga las instrucciones del terapeuta!**

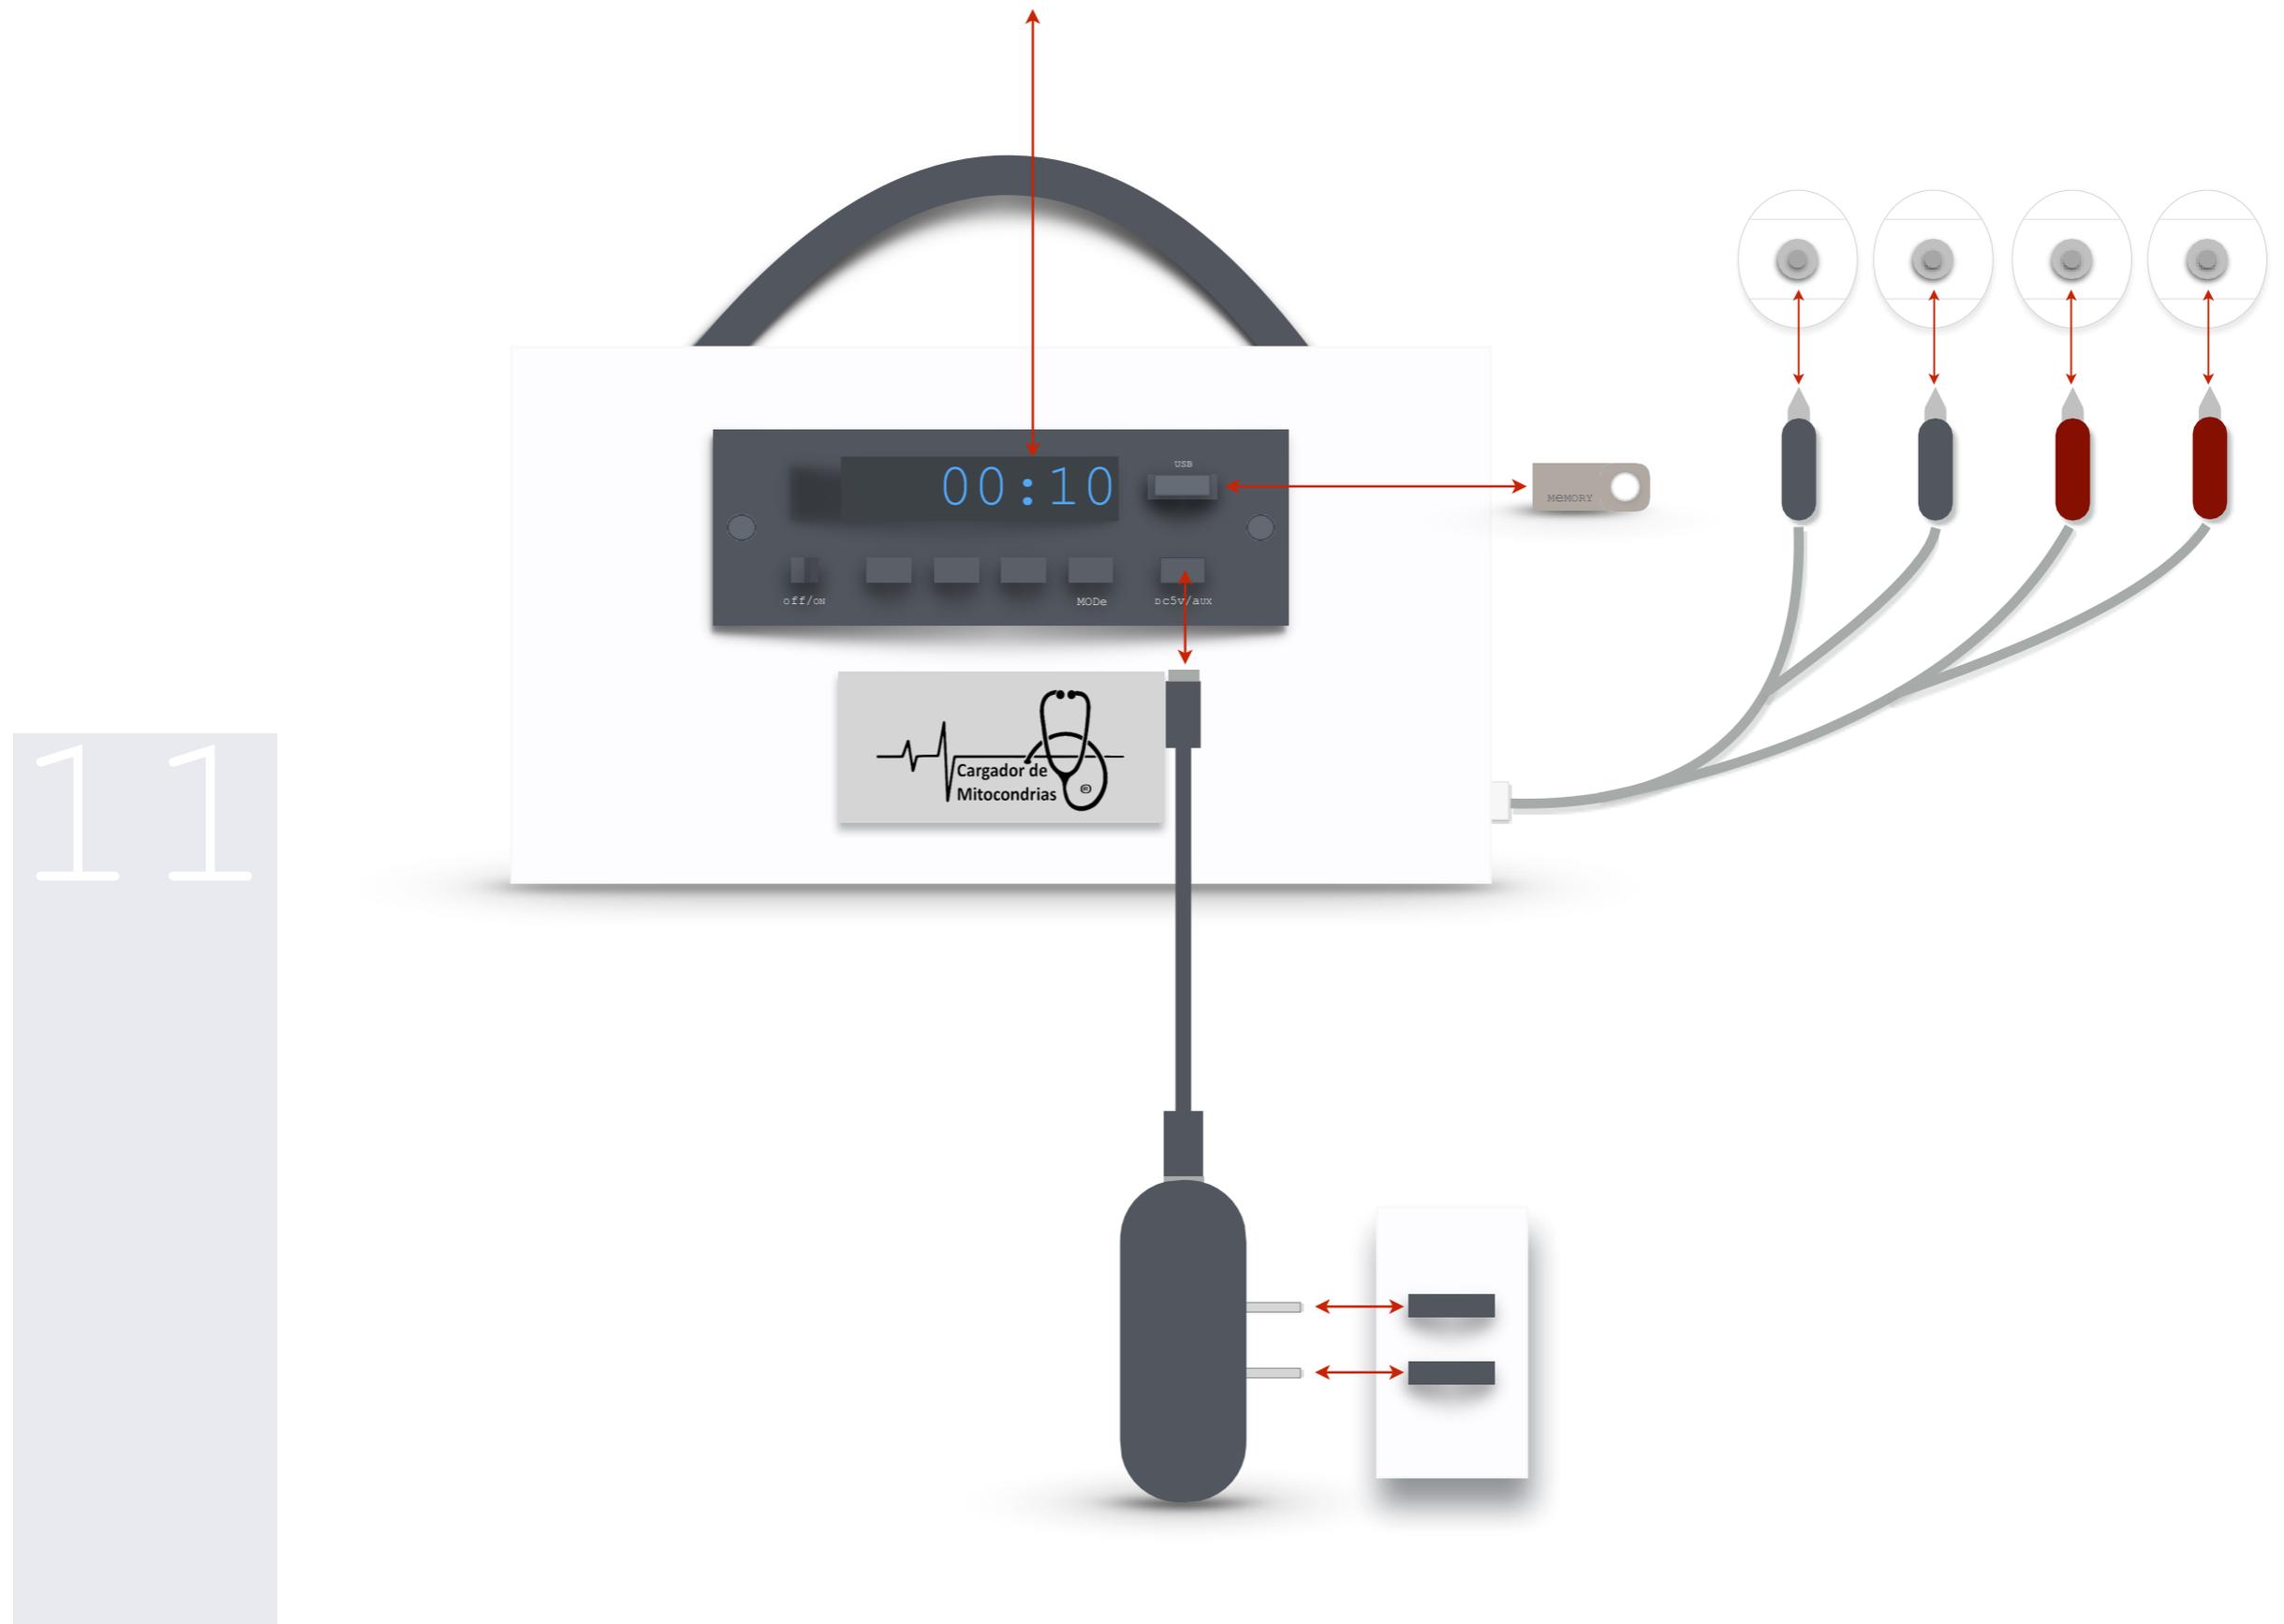

## ¡ IMPORTANTE !

Si el equipo se apaga, reinicia o aparecen números erráticos en el contador de pulsos del display, sustituya el eliminador por uno de celular. Usan el mismo voltaje.



**RAUL MACIAS / INVENTOR**  
CARGADOR DE MITOCONDRIAS

12

En caso de pregunta o duda, no deje de comunicarse; muchas gracias por confiar en nosotros.

¡ GRACIAS POR ADQUIRIR EL CARGADOR DE MITOCONDRIAS !

Correo: INFO@CARGADORDEMITOCONDRIAS.COM



D E R E C H O S R E S E R V A D O S

*MARCA REGISTRADA*

[www.cargadordemitocondrias.com](http://www.cargadordemitocondrias.com)